



MESURE DE RÉFÉRENCE POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ DE VOTRE COLOSTRUM

QUALITÉ DU COLOSTRUM

Objectif: 300 g IgG jour 1
min 150 g endéant les 2h.

Concentration en IgG (g/l)		Objectif: Volume (l) à donner avant 6h de vie =200 g.en IgG	Mesure en % Brix pour réfractomètre
0 25	MAUVAIS	> 8 8	0 21
50 75 90	BON ++	4 2,7 2,2	22 25 28
100 125	EXCELLENT ++++	2 1,6	29 32

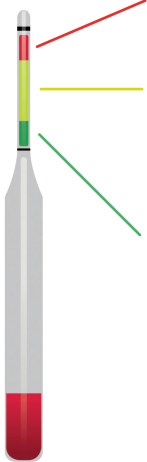

STARMILK

Osez la performance

